




EKG ELEKTROTLARI & STERİLİZASYON ÜRÜNLERİ
ECG ELECTRODES & STERILIZATION PRODUCTS

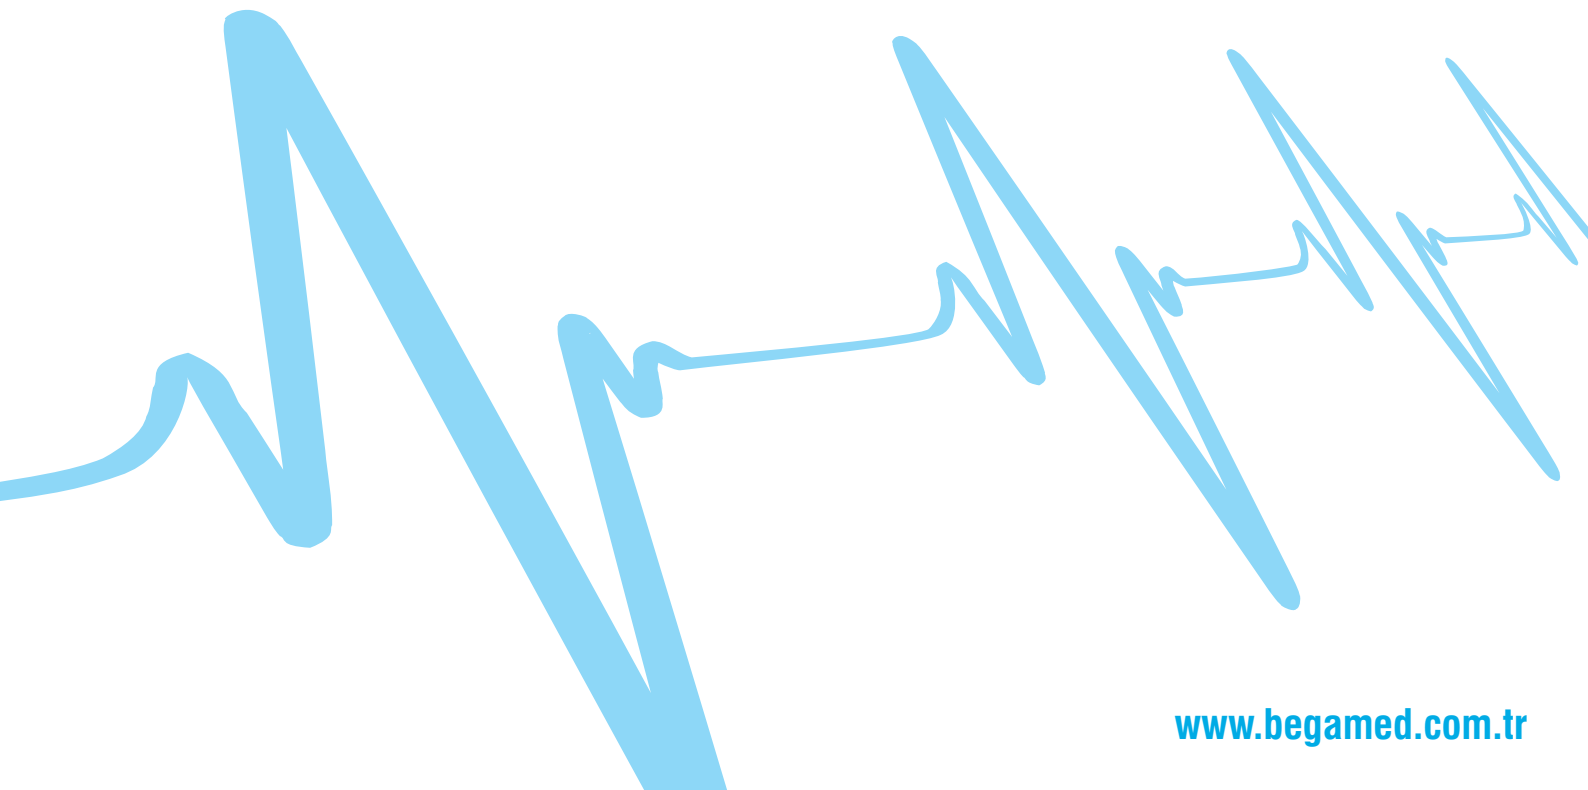

EKG ELEKTROTLARI (Pediatrik / Yetişkin)

ECG ELECTRODES (Pediatric / Adult)

BM 25



BM 42



BM 37



BM 50



- Yumuşak ve esnektir, vücut kıvrımlarına uyum sağlar.
- Yapışkanı hipoalerjenik akriliktir, cildi tahriş etmez, yapışkanlık kapasitesi yüksektir.
- Çıkarıldığında ciltte atık bırakmaz.
- Dış çitçiti paslanmaz çeliktir.
- Gümüş klorid sensörü hızlı ve kaliteli trase verir.
- Katı jelli, sızıntı yapmaz, cildi tahriş etmez.
- Elektrotlar hava temasını önleyecek özel poşetlerde ve üzerinde son kullanma tarihi ve lot. numaralıdır.
- Raf ömrü en az 2 yıldır.
- Ürünün yetişkin ve pediatrik boyları bulunmaktadır.
- Sirt materyali köpüktür.

- Soft and elastic enough to fix all body parts.
- Acrylic base adhesive is hypoallergenic, good stickiness and no irritation.
- After removing will not leave residue on skin.
- Outer snap is stainless steel.
- Zinc chloride sensor gives fast and sensitive respond.
- Non irritant solid gel with foam back.
- Heat sealed aluminized packages keeps them fresh and have all details on it.
- Shelf life is 2 years.
- We have pediatric and adult sizes.

BEGAMED®

- Begamed sterilizasyon bantları sterilizasyon paketlerinin güvenli bir şekilde kapatılması için üretilmiştir.
- Bant üzerindeki indikatörler paketlerin sterilizasyona girip girmediğini net bir şekilde görülmesini sağlar.
- Buhar ve etilen oksit sterilizasyonu için uygundur bantlarımız mevcuttur.
- Paketleme materyalleri üzerinde kalıntı bırakmadan çıkarılabilirler.
- Bütün boylarda ve indikatörlü yada indikatörsüz olarak temin edilir.

- Begamed sterilization tapes are made for secure and safe closing of sterilization packs.
- The process indicator ink shows an easy and accurate color change and indicates if the pack has been processed.
- The tapes for steam and ethylene oxide sterilization processes available. Provide a clean peel without residue from the wrapping materials.
- Provide a clean peel without residue from the wrapping materials.
- All tape sizes are available with indicator ink or neutral fixing tapes.



MEDİKAL KREP KAĞITLARI (WRAP)

CREPE WRAPPING PAPERS

- Begamed çeşitli kullanımlar için uygun boyutlarda krepe kağıt sağlayabilir. Wrap kağıtlarımız % 100 selüloz liflerinden üretildiği için iç ve dış paketleme için kullanılabilir.
- Buhar, etilen oksit, formaldehit ve radyasyon sterilizasyonu için kullanılırlar.
- Begamed tarafından sağlanan wrap kağıtları bütün uluslararası standartlara uygundur.


ÖLÇÜ	KOD
50 x 50	WP 50
60 x 60	WP 60
75 x 75	WP 75
90 x 100	WP 90
100 x 100	WP 100
120 x 120	WP 120
130 x 130	WP 130
130 x 150	WP 130-15
140 x 140	WP 140
150 x 150	WP 150

- Begamed offers a wide range of wraps for different purposes. Begamed crepe wrapping paper are made of 100% cellulose fibers and can be used as either inner or outer wrapping.
- Crepe wraps are suitable for steam, ethylene oxide, formaldehyde and radiation sterilizations methods and are a reliable solution for preventing cross contamination with bacteria.
- Wrapping papers offered by Begamed are in compliance with all international standards.



ANTİMİKROBİYEL YAPIŞKANLI GİRİŞ PASPASLARI

CONTAMINATION CONTROL MATS

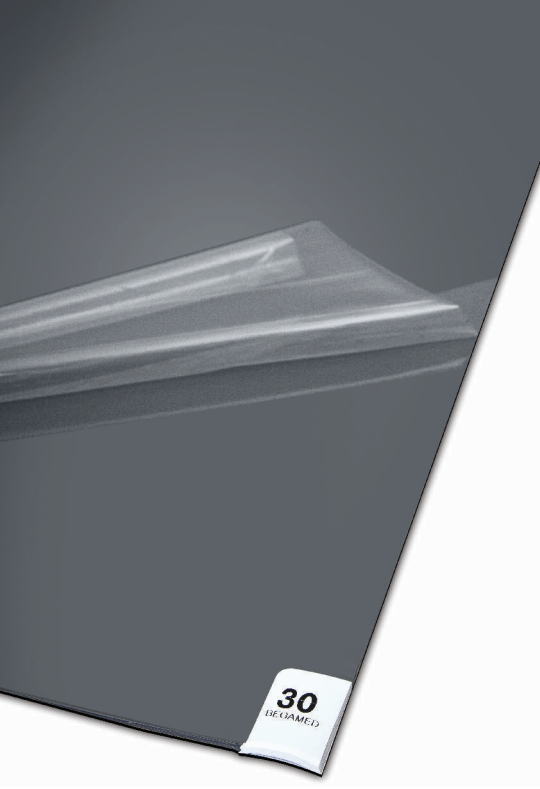

AP - 30 (30 YAPRAK)
AP - 40 (40 YAPRAK)

- Paspaslar 30 yapraklıdır.
- 1 Ped 1,50 mm kalınlığındadır.
- Çerçevesiz kullanıma uygundur.
- Paspasın altında kontaminasyon oluşmaması için alt tabakanın tüm yüzeyi yapışkandır.
- Her yaprak numaralıdır.
- Antimikrobiyel ajan içerir.
- 45 x 115 cm. ölçülerindedir.

- 30 sheets / mat
- 1.5 mm thickness / sheet
- Can be used with or without frame.
- Full back adhesive Numbered sheets Antimicrobial agent.
- 45 x 115 cm size

DÖKÜMANTASYON ETİKETLERİ GL - 600

STEAM - E.O. LABELS

- Begamed etiket indikatörler çift katlı yapışkanlıdır.
- Etien oksit ve buhar indikatörleri veya renk kodlamalı olarak temin edilebilir.
- Kurşun içermeyen indikatörler ISO 11140-1 standardına uygundur. Ve başarılı sterilizasyon sonrası doğru renk değişimini gösterir.
- Begamed etiket tabancaları ile kodlama yapılarak dökümantasyon dosyalarınızda saklayabilirsiniz.

- Begamed adhesive indicator labels are self-adhesive double labels.
- Available with chemical indicator for steam and ethylene oxide sterilization methods. Also can be supplied neutral and color printed.
- The lead free chemical indicators in compliance with ISO 11140-1 provide an easy interpretation and will show an accurate indicator color change after successful sterilization cycle.
- With Begamed Label Gun the labels can be printed for traceability including data: sterilization and expiry date, autoclave and cycle no...



DÖKÜMANTASYON ETİKET TABANCALARI

LABEL GUNS

LG - 600



BEGAMED®

CLASS 6 BUHAR İNDİKATÖR STRİPLERİ

CLASS 6 STEAM INDICATOR STRIPS

Buhar İndikatörü BS - 250
E.O. İndikatörü ES - 250



- Begamed class 6 buhar indikatör şeritleri 121°C -15 dakika ve 134°C -3.5 dakika buhar sterilizörleri için tasarlanmıştır.
- Çevrim doğrulama amaçlı indikatörlerimiz her pakette kullanılabilir. Paket içine buhar penetrasyonunun sağlandığı ve bütün kritik parametrelerin varlığını tespit eder.
- ISO-11140-1 standartlarında üretilmiş su bazlı, non-toksik kimyasal indikatörlerimiz başarılı sterilizasyon çevriminde kesin ve net renk değişimi gösterirler.

- Begamed Class 6 Emulating steam indicator strips are designed to be used in steam sterilizers operating at 121°C – 15 minutes and 134°C – 3.5 minutes.
- The cycle verification indicators can be used in every pack and will provide assurance of steam penetration into the packs and presence of all critical parameters of steam sterilization cycle.
- The water based and non-toxic chemical indicator in compliance with ISO 11140-1 will show a clear and accurate color change after successful steam sterilization.

BOWIE & DICK TEST PAKETİ

BOWIE DICK TEST PACK

BD - 200 (200 Yaprak)



BD - 400 (400 Yaprak)




- Begamed Bowie-Dick test paketleri EN 285 yönergesine göre 134°C / 3.5 dakika pre-vakum tip sterilizatörlerin hava tahliye performansını test etmek amacı ile üretilmiştir.
- Paket merkezinde su bazlı non-toksik indikatör mürekkebi basılı test yaprağı bulunmaktadır.
- Test yaprağındaki düzenli renk değişimi sterilizasyon sırasında havanın mükemmel bir şekilde tahliye edildiğini gösterir. İndikatör test yaprağının arkasında ise dökümantasyon için

- Pre-assembled, single use Begamed Bowie & Dick Test Packs designed to test the performance of the air removal system of pre-vacuum assisted sterilizers in compliance with EN 285 and operating at 134°C / 3.5 minutes cycles. An indicator sheet printed with water based.
- Non-toxic chemical indicator is placed at the center of each pack. The uniform color change of the indicator sheet after steam sterilization indicates that all air removed.
- The backside of the indicator sheet has fields to be filled out and it can be kept as a permanent record for documentation.

BEGAMED®

KONTEYNER KİLİDİ
CONTAINER LOCK

KK - 100

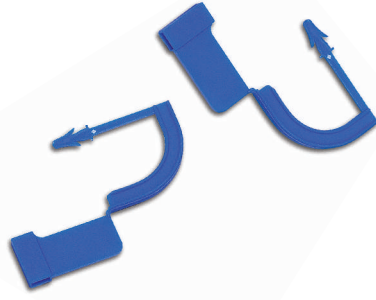

BEGAMED®

For single use
Bir kullanımlık kağıt filtre
Nur für einmaligen



konteynir için
for Container
für Container



BG-040


DARK GREEN / KÖYÜ YEŞİL
STERİL / STERILIZED

KF - 100

KONTEYNER FİLTRESİ
FILTER FOR CONTAINER

KONTEYNER ETİKETİ
LABEL FOR CONTAINER

KE - 100

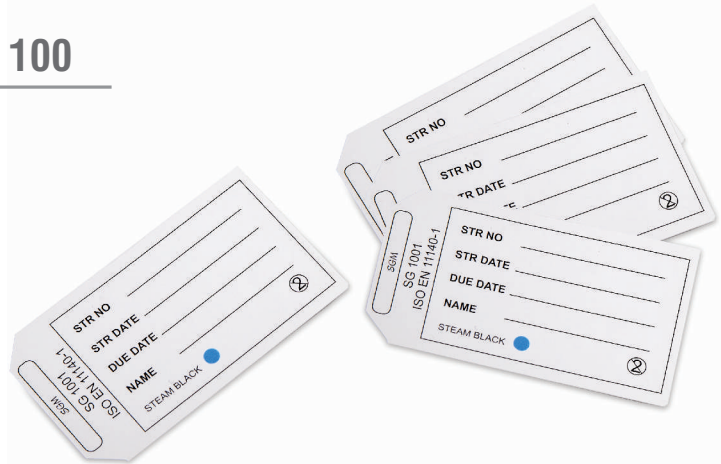

BEGAMED®

TERMOPLASTİK BURUN SPLİNT

THERMOPLASTIC NASAL SPLINT



- Katı, opak, hafif, termoplastik materyalden yapılmıştır.
- Basitçe, sıcak suda (71°C) yumuşatıp bantlanmış burun üzerine kıvrılarak uygulanır.
- It is made of solid, opaque, lightweight, thermoplastic material.
- It is simply applied by softening it in hot water (71°C) and curling it over the taped nose.

ALÜMİNYUM BURUN SPLİNT

ALUMINUM NASAL SPLINT



- Yumuşak alüminyumdan yapılmıştır.
- Ateller velcro (birbirini karşılayacak şekilde yapışkan) olarak tasarlanmıştır.
- Kullanım süresi 7-10 gündür.
- Uygulaması sadece 60 saniye sürer.
- Kemikleri verilen pozisyonda tutar ve burnu sabitler; ödemi azaltır.
- Ateller, subkütan dokulara yumuşak bir basınç sağlar.
- Dorsal pad basınç uygulanan yerde ölü nokta kalmasını, derinin katlanmasını ve buruşmasını engelleyerek «gaga burun» olasılığını azaltır.
- Made of soft aluminum.
- The splints designed as velcro (Adhesive to meet each other)
- The duration of use is 7 – 10 days.
- Implementation takes only 60 seconds.
- It holds the bones in the given position and fixes the nose; reduces edema.
- Splints provide a gentle pressure on the subcutaneous tissues.
- The dorsal pad prevents the dead spot from remaining where the pressure is applied, the skin from floding and wrinkling, reducing the likelihood of a “beak nose”.

ALÜMİNYUM VE TERMOSPLİNT ÖZELLİKLERİ:

- Kemikleri sabitleyebilecek sağlamlıkta.
- Elle bükülebilir ancak ödeme karşı dirençli.
- Yapıştırılabilir.
- Kullanımı kolay ve hızlı.
- Leke tutmayan özellikte.
- Geçirgen, hava sirkülasyonu sağlayarak dokuyu kuru tutar.
- Dışardan gelen etkilere karşı dirençli, sert yüzeyli.
- Göze çarpmayan tasarımda.
- Su geçirmez.
- Giysilere takılmayan pürüzsüz kenarlı.

Nasal splintler travma veya rinoplasti operasyonları sonrasında hassas burun kemiklerini koruyan, yapılan cerrahinin iyi sonuç vermesine yardımcı olan ve tedavi amaçlı kullanılan bir alettir. Operasyon geçirmiş burnu ikincil bir travmadan korur ve yapılan değişikliği doğru pozisyonda sabit tutar, ödemi engeller.

NASAL SPLİNT NEDEN GEREKLİDİR?

- Kullanılmazsa burun kemiği ve kıkırdakları segmentlerinde deformite ve havayolu tıkanıklığı oluşabilir.
- Hematoma (deri altı kanama) oluşabilir.
- Burnun uç kısmında yara dokusu birikimi sonucu «polybeak»(gaga burun) deformitesi oluşabilir.
- Fazla protein toplanması sebebiyle enfeksiyon riski artar.
- Doku geriliminden dolayı ağrı oluşur.

PROPERTIES OF ALUMINUM AND THERMOSPUNT

- It is strong enough to fix bones.
- It can bent by hand, but it is resistant to edema.
- It can be sticked.
- Easy and fast to use.
- It doesn't stain.
- Permeable, it keeps the tissue dry by providing air circulation.
- Resistant to external influences, with a hard surface
- Inconspicuous desing
- Waterproof
- Smooth edges that don't stick to clothes.

It is a splint that protects sensitive nasal bones after trauma or rhinoplasty operations, helps to give a good result of the surgery performed, and is used for therapeutic.

Purposes. It protects the operated nose from a secondary trauma and keeps the made change fixed in the correct position, prevents edema.

WHY IS NASAL SPLINT NEEDED?

- If it is not used, deformity and airway obstruction may occur in the nasal bone and cartilage segments.
- Hematoma (subcutaneous hemorrhage) may occur.
- Deformity (Beak Nose) may occur as a result of accumulation of scar tissue at the tip of the nose.
- The risk of infection increases due to the accumulation of excess protein.
- Pain occurs due to tissue tension.

FOTOTERAPİ GÖZ BANDI

PHOTOTHERAPY EYE PATCH

- % 99,9 ışık bloklama
- Mükemmel uyum için ayarlanabilir bant tasarımı
- Lateks içermez.
- Etilen oksit ile steril edilmiştir.

- 99,9 % light blocking
- Adjustable band design for the perfect fit.
- Latex-free
- Sterilized with ethylene oxide.



CERRAHI MASKE

MASK

- Cilde dost
- Paraben içermez
- Lateks içermez
- Naylon içermez
- Klor içermez

- Skin friendly
- Paraben free
- Latex free
- Nylon free
- Chlorine free

CERRAHI MASKE ÇOCUK

MASK KIDS

- Cilde dost
- Paraben içermez
- Lateks içermez
- Naylon içermez
- Klor içermez

- Skin friendly
- Paraben free
- Latex free
- Nylon free
- Chlorine free



BEGAMED®



S E R T İ F İ K A

BEGAMED®

BEGAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. İÇ VE DİŞ TİC. A.Ş.

BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. 1. CAD. MERMERÇİLER SAN. SİT. NO:5 KONYALILAR
İŞ MERKEZİ K.2 D.8 NO:1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

**TÜM VÜCUT EKG ELEKTRODLARININ ÜRETİMİ, PAKETLEMESİ, SATIŞI VE STERİLİZASYON
MALZEMELERİNİN ÜRETİMİ, TEMİNİ, SATIŞI İLE TIBBİ MALZEME VE CİHAZLARIN İTHALATI,
İHRACATI VE SATIŞI**
PRODUCTION, PACKING AND SALES OF ALL BODY ECG ELECTRODES, PRODUCTION, SUPPLY
AND SALES OF STERILIZATION SUPPLIES AND IMPORT, EXPORT AND SALES OF MEDICAL
SUPPLIES AND EQUIPMENTS

kapsamında
with a scope of

ISO 9001:2015

Uluslararası Kalite Sistemi standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuştur.
has established a quality management system that is in compliance with the International Quality
Management System Standard.



TÜRKAK BDS NO
YS-CD46-6626

Y 1559
Sertifika No
Certificate No.

23, 29
EA Kodu
E&I Code

27.03.2015
İlk Yayın Tarihi
Initial Date

08.03.2022/07
Sertifika Yayın Tarihi / Rev.No.
Date of This Certificate / Rev.No.

26.03.2023
Sertifika Geçerlilik tarihi
Certificate Expiry Date

27.03.2021-26.03.2024
Belgelendirme Periyodu
Certification Period

Sertifika Doğrulama İşlemi: mobil cihazlar aracılığıyla belge üzerindeki QR kod okutularak veya "TÜRKAK BDS No" ile <https://bds.turkak.org.tr> belge doğrulama sisteminden yapılabilir.
The Certificate Validation process can be done with mobile devices by scanning the QR Code on the document or by using the "TÜRKAK BDS No" and the <https://bds.turkak.org.tr> document verification system.



F-1846(0)
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0091-YS

Zühre Özdemir
GENEL MÜDÜR
General Manager





Bu belge YBM'nin belgelendirme kurallarına uyulması ve periyodik ara denetimlerin başarıyla tamamlanması kaydıyla geçerlidir.
This certificate is effective if it is complied with the certification rules of YBM and periodic surveillance audits are completed successfully. Please call us for more information.

Yönetim Belgelendirme Merkezi Test ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Tuzla Mah. Göl Sok. No:1-3 Kat: 1 D.4 Zeytinburnu / İstanbul Tel: 0212 547 31 00
info@ybm.com.tr www.ybm.com.tr



S E R T İ F İ K A

BEGAMED®

BEGAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. İÇ VE DİŞ TİC. A.Ş.

BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. 1. CAD. MERMERÇİLER SAN. SİT. NO:5 KONYALILAR İŞ MERKEZİ K.2 D.8 NO:1
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

**TÜM VÜCUT EKG ELEKTRODLARININ ÜRETİMİ, PAKETLEMESİ, SATIŞI VE STERİLİZASYON
MALZEMELERİNİN ÜRETİMİ, TEMİNİ, SATIŞI İLE TIBBİ MALZEME VE CİHAZLARIN
İTHALATI, İHRACATI VE SATIŞI**
PRODUCTION, PACKING AND SALES OF ALL BODY ECG ELECTRODES, PRODUCTION, SUPPLY
AND SALES OF STERILIZATION SUPPLIES AND IMPORT, EXPORT AND SALES OF MEDICAL
SUPPLIES AND EQUIPMENTS

kapsamında
with a scope of

ISO 11140-1:2014

Uluslararası Sağlık Malzemelerinin Sterilizasyonu Standardına uygun bir sistem kurmuştur.
has established a system that is in compliance with the International Sterilization Of Health Care
Products System Standard.

CE 1002
Sertifika No
Certificate No.

23, 29
EA Kodu
E&I Code

13.05.2016
İlk Yayın Tarihi
Initial Date

08.03.2022/07
Sertifika Yayın Tarihi / Rev.No.
Date of This Certificate / Rev.No.

12.05.2023
Sertifika Geçerlilik tarihi
Certificate Expiry Date

13.05.2022-12.05.2025
Belgelendirme Periyodu
Certification Period

Yönetim Belgelendirme Merkezi Test ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Tuzla Mah. Göl Sok. No:1-3 Kat: 1 D.4 Zeytinburnu / İstanbul Tel: 0212 547 31 00 Faks: 0212 547 76 00
info@ybm.com.tr www.ybm.com.tr



S E R T İ F İ K A

BEGAMED®

BEGAMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. İÇ VE DİŞ TİC. A.Ş.

BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. 1. CAD. MERMERÇİLER SAN. SİT. NO:5 KONYALILAR İŞ MERKEZİ K.2 D.8 NO:1
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

**TÜM VÜCUT EKG ELEKTRODLARININ ÜRETİMİ, PAKETLEMESİ, SATIŞI VE STERİLİZASYON
MALZEMELERİNİN ÜRETİMİ, TEMİNİ, SATIŞI İLE TIBBİ MALZEME VE CİHAZLARIN İTHALATI, İHRACATI VE
SATIŞI, CERRAHİ MASKE, CERRAHİ ÖNLÜK, MEDİKAL EL DÜVENE, GALOŞ,
ÜRETİMİ VE SATIŞI**
PRODUCTION, PACKING, SALES OF ENTIRE BODY ECG ELECTRODES and PRODUCTION,
SUPPLY, SALES OF STERILIZATION MATERIALS and IMPORT, EXPORT AND SALES OF MEDICAL
MATERIALS and DEVICES, and PRODUCTION and SALES OF SURGICAL MASK, SURGICAL GOWN,
MEDICAL GLOVE, GALOSH

kapsamında
with a scope of

ISO 13485:2016

Tıbbi Cihazlar - Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun bir sistem kurmuştur.
has established that it is in compliance with the Medical Devices Quality Management System Standard.

MD01004
Sertifika No
Certificate No.

13.03.2018
İlk Yayın Tarihi
Initial Date

08.03.2022/06
Sertifika Yayın Tarihi / Rev.No.
Date of This Certificate / Rev.No.

12.03.2023
Sertifika Geçerlilik tarihi
Certificate Expiry Date

13.03.2021-12.03.2024
Belgelendirme Periyodu
Certification Period

Yönetim Belgelendirme Merkezi Test ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Tuzla Mah. Göl Sok. No:1-3 Kat: 1 D.4 Zeytinburnu / İstanbul Tel: 0212 547 31 00 Faks: 0212 547 76 00
info@ybm.com.tr www.ybm.com.tr

BEGAMED®



BEGAMED®
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

YETKİLİ BAYİ

www.begamed.com.tr